


1. Conectar:

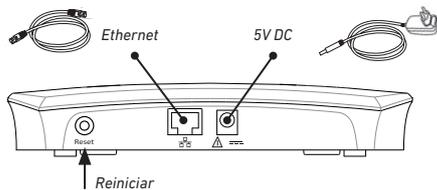

2. Obtener la dirección IP: Pulse la tecla
- en un teléfono snom M65/M85 (no incluido en la caja)
  - en un teléfono M25 (no incluido en la caja)
- y introduzca "47" para buscar la dirección IP de la base.
3. Abra el navegador de un PC en la misma red que la estación base, y escriba la dirección IP en la barra de direcciones para abrir la interfaz web de la base. Nombre de usuario y contraseña por defecto es: admin.

Para obtener información sobre la configuración de la base y las extensiones, consulte el manual de usuario que se encuentra en la página de producto de la serie M en [www.snom.com](http://www.snom.com).

**Snom Technology GmbH**  
 Wittestr. 30 G  
 13509 Berlin, Deutschland  
 Tel. +49 30 39 83 3-0  
 Fax +49 30 39 83 31 11  
[office.de@snom.com](mailto:office.de@snom.com)


**Snom, Inc.**  
 2603 Camino Ramon, Suite 420  
 San Ramon, CA 94583, USA  
 Tel. +1 339 227 6160  
 Fax +1 339 227 6180  
[office.us@snom.com](mailto:office.us@snom.com)

**Snom Technology GmbH**  
 The Courtyard  
 High Street  
 Ascot, Berkshire SL5 7HP, UK  
 Tel. +44 161 348 7500  
 Fax +44 169 348 7509  
[office.uk@snom.com](mailto:office.uk@snom.com)

**Snom Technology GmbH**  
 6 Parc des fontenelles  
 78870 Bailly, France  
 Tel. +33 1 80 87 62 87  
 Fax +33 1 80 87 62 88  
[office.fr@snom.com](mailto:office.fr@snom.com)

**Snom Technology GmbH**  
 Via Milano 1  
 20020 Lainate, Italia  
 Tel. +39 02 00611212  
 Fax +39 02 93661864  
[office.it@snom.com](mailto:office.it@snom.com)

**Snom Technology Ltd.**  
 Rm. 828, 5F, No.285, Sec. 4  
 Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist.  
 Taipei City 10692, Taiwan  
 Tel. +886 2 8751 1120  
 Fax +886 2 8751 1130  
[office.tw@snom.com](mailto:office.tw@snom.com)

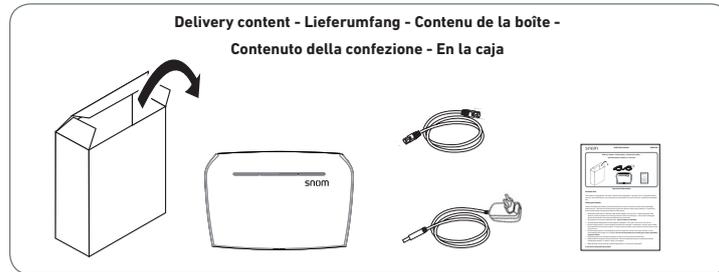

**Información Importante**

**Uso previsto**

Este producto ha sido proyectado para ser utilizado con un teléfono de la serie snom M. Cualquier otro uso será considerado impropio. Cualquier operación de modificación o montaje no ilustrada explícitamente en el manual de uso será considerado uso impropio.

**Precauciones de seguridad**

Antes de utilizar el dispositivo, leer atentamente las siguientes precauciones e instrucciones relativas a las modalidades de instalación y uso del teléfono. Conserve esta hoja de información y no entregue el dispositivo a terceros sin ella.

- Utilizar únicamente el adaptador entregado con la estación base o uno expresamente recomendado por snom. Otros adaptadores de alimentación pueden dañar o incluso destruir la estación base.
- Evite colocar los cables donde se pueda tropezar con ellos. Evite colocar los cables donde pueda estar expuesto a presión mecánica, podrían dañarse. Si un cable está dañado, desconecte el dispositivo y contacte con personal cualificado de servicio.
- El producto es para instalación en interior. ¡NO ADECUADO PARA INSTALACIÓN EXTERIOR!
- El producto se puede utilizar en lugares con temperaturas comprendidas entre -10°C y +50°C (14°F and 122°F).
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevado (por ejemplo en baños, lavaderos o sótanos húmedos). No sumerja el producto en agua ni derrame o vierta líquidos de ningún tipo sobre o dentro de ninguna pieza del teléfono.
- Instale el producto con una distancia mínima a las personas y los animales de 100 cm.
- No instale el producto en entornos con riesgo de explosiones ni use el teléfono en dichos entornos (talleres de pintura, por ejemplo). ¡NO use el producto si huele a gas u otros gases potencialmente explosivos!
- Los dispositivos médicos pueden verse afectados. Tenga en cuenta las implicaciones técnicas cuando instale, por ejemplo, el producto en la consulta de un médico.
- PARA ESTADOS UNIDOS: No utilizar cerca de instrumentos médicos o si se utiliza un marcapasos.

**Si tiene un marcapasos implantado**

- No lo use si tiene un marcapasos implantado a menos que las instrucciones del fabricante del marcapasos permiten explícitamente el uso de dispositivos que emitan señales de radiofrecuencia por pulsos. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

- Distancia MÍNIMA recomendada con el producto: 20 cm (7.9").
- Agunte el producto sobre el oído opuesto al dispositivo médico para minimizar potenciales interferencias.
- Apague de inmediato el producto si tiene cualquier motivo para sospechar que se están produciendo interferencias.
- PARA ESTADOS UNIDOS: No utilizar si se utiliza un marcapasos.

## Información adicional de seguridad

### Niños pequeños

Su dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

### Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir cualquier normativa aplicable de cualquier zona, y apague siempre el aparato cuando el uso esté prohibido o cuando pueda provocar interferencias o riesgos. Use el dispositivo solamente en sus posiciones de funcionamiento habituales. No ponga tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnético cerca del dispositivo, podría borrarse la información guardada en ellos.

### Dispositivos médicos

El uso de cualquier equipo que emita señales de radiofrecuencia puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos no aislados correctamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si están aislados correctamente de energía de radiofrecuencia (RF) externa o si tiene dudas respecto a este asunto. Apague el dispositivo en instalaciones clínicas cuando las señales colgadas en estas áreas se lo indiquen. Los hospitales o instalaciones clínicas pueden usar equipos sensibles a energía de RF externa.

### Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan una distancia mínima de 20 cm (7.9") entre dispositivos inalámbricos y un dispositivo médico implantado, como marcapasos o desfibriladores cardiovasculares, para evitar potenciales interferencias con el dispositivo médico. Las personas que tengan estos dispositivos deben:

- Mantenga siempre el dispositivo inalámbrico a más de 20 centímetros (7.9") del dispositivo médico cuando el dispositivo inalámbrico esté encendido.
- No lleve el dispositivo inalámbrico en el bolsillo de la camisa.
- Agunte el dispositivo inalámbrico sobre el oído opuesto al dispositivo médico para minimizar potenciales interferencias.
- Apague de inmediato el dispositivo inalámbrico si tiene cualquier motivo para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Lea y obedezca las instrucciones del fabricante del dispositivo médico.

Si tiene dudas sobre el uso de su dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor médico.

### Cumplimiento SELV (Safety Extra Low Voltage - Seguridad de Tensión Extra Baja)

Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada/salida cumplen con los requisitos SELV.

### Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo cuando esté en una zona con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las indicaciones e instrucciones. Las chispas en estas zonas pueden provocar una explosión o incendio, provocando heridas o incluso muerte. Apague el dispositivo en zonas de repostado, como cerca de los surtidores de gasolina en estaciones de servicio. Obedezca las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de carburante, zonas de almacenaje y distribución, plantas químicas, o

lugares en los que se produzcan operaciones de demolición. Las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen cubiertas cerradas de barcos, instalaciones de transferencia o almacenaje químico, vehículos que usan gases de petróleo líquido, y zonas en las que el aire contenga químicos o partículas como polvo grano o virutas metálicas.

### Equipos electrónicos delicados

El estado actual de las investigaciones concluye que los teléfonos DECT operativos no afectan normalmente a equipos electrónicos. Sin embargo, debe tomar ciertas precauciones si desea usar teléfonos DETC cerca de este tipo de equipos, como equipo de laboratorio delicado. Mantenga siempre una distancia mínima de 10 cm (3.94") del equipo incluso si el teléfono está en espera.

### Subidas de tensión

Recomendamos instalar un limitador de subidas de tensión CA en la toma CA a la que se conecte este dispositivo para evitar daños al equipo, provocados por rayos locales u otras subidas de tensión eléctrica.

### Limpieza

Use una gamuza antiestática. Evite usar agua y productos de limpieza líquidos o sólidos, podrían dañar la superficie o la electrónica interna de la base, el cargador y el teléfono.

### Eliminación



Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2002/96/EC, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar el dispositivo al final de su vida útil, contacte con su municipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor.

### Eliminación para países fuera de la Unión Europea

La eliminación de productos eléctricos y electrónicos en países fuera de la Unión Europea debe realizarse de acuerdo con las normativas locales. Contacte con su autoridad local para más información.

### Cumplimiento con la normativa



Este producto tiene el marcado CE y la certificación FCC, y cumple con los estándares de salud, seguridad y medioambientales europeos y de Estados Unidos. snom puede proporcionar una declaración de conformidad (para obtener la dirección, consulte la página 4). FCC ID: T7HX8660

Todas las modificaciones, los cambios y la apertura no autorizada del dispositivo provocarán la cancelación de la garantía, y también pueden causar la pérdida del marcado CE y de la certificación FCC. En caso de avería, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado, con su vendedor o con snom.

- **Seguridad:** IEC 60950-1:2005
- **Conector Ethernet:** RJ45 (8P8C)
- **Alimentación:** Adaptador SMPS Ten Pao, tensión de entrada 100-240 VAC, tensión de salida 5V DC 600 mA, conector coaxial
  - EU: Adaptador SMPS Ten Pao, modelo nº S003GV0500060
  - US: Adaptador SMPS Ten Pao, modelo nº S003GU0500060
- **Banda de frecuencia:** 1880-1900 MHz (EU), 1910-1930 MHz (LATAM), 1920-1930 MHz (US)